

“全自动血型分析仪一套”院内论证公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对设备科申请的“全自动血型分析仪1台”项目进行院内论证，欢迎符合条件的供应商前来报名，现将本次论证的有关事项公告如下：

- 1、项目编号：GLSZYYY202329
- 2、项目名称：全自动血型分析仪1套
- 3、资金来源：财政资金
- 4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。
- 5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。
- 6、报名时间：2023年7月12日-7月18日（上午8：00-12：00，下午15：00-18：00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。
- 7、会议时间：另行通知（报名商家应密切留意本网站最新会议时间公告通知）。
- 8、报名地点：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室。请网上报名，报名要求见附件。（报名邮箱 glzyyzbb@163.com）
（注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）
- 9、联系人及电话：谢老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2023年7月12日

附件 1. 桂林市中医医院院内论证报名表

报单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
竞标项目 (竞标商家必填)			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			

报名指定邮箱: glzyyzbb@163.com; 1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息: 项目编号+项目名称 (多项目时需注明对应报价表中的序号)+公司名称; 2. 报名表需发电子 word 文档, word 文档的文件名需注明: 项目编号+项目名称+公司名称; 3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

1. 参会商家把填写完整报名表 (**word 文档**)、相关资质证明 (**PDF 文档**) 【三证合一营业执照复印件 (盖鲜章)、法定代表人身份证正反面复印件、法人授权委托书 (盖鲜章, 委托代理时必须提供)、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上 (含县级) 社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2023 年中近三个月的社保证明复印件 (委托代理时必须提供) 及供应商相关项目资质证明合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱, 即完成商家参会报名手续。

2. 商家完成报名手续后即准备参会文件, 参会文件包含 (**以下内容很重要, 请仔细阅读并按顺序装订成册**):

①报价表;

②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等;

③三证合一营业执照复印件 (盖鲜章)、法定代表人身份证正反面复印件、法人授权委托书 (盖鲜章, 委托代理时必须提供)、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上 (含县级) 社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2023 年中近三个月的社保证明复印件 (委托代理时必须提供) 及供应商相关项目资质证明; 注: 投标人成立不足 1 个月的, 无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。



④售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章, 正本 1 份, 副本 8 份, 正本需装订整齐成册要有封面 (装订样式见附后)

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本需装订成册、副本装订样式。

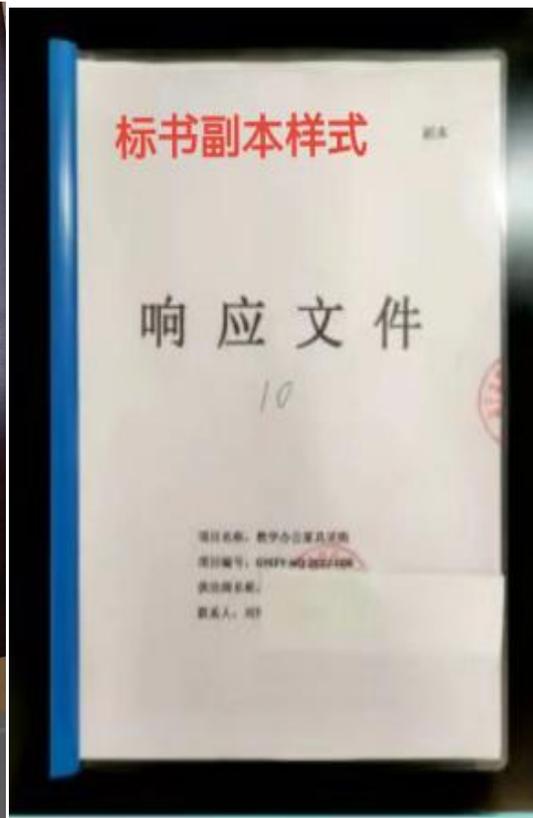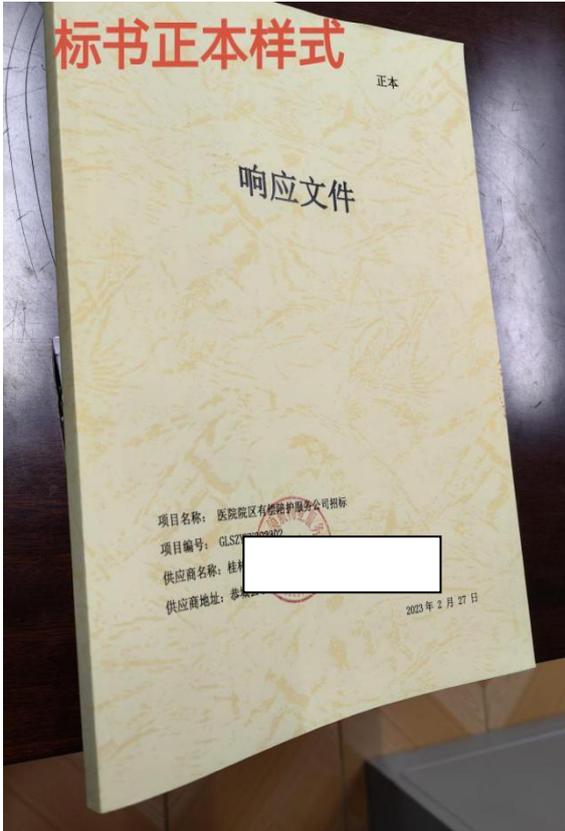

附件 2. 项目报价表

单位：万元

供应商 (盖章)：									
联系人：					联系电话：				
序号	产品名称	数量	单位	生产厂家	品牌型号	单价	总价	质保期限	备注
1									
2									
	合计								
此项目为交钥匙项目，以上报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试、计量检测、接入医院信息系统，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。按国家有关产品三包规定执行“三包”政策，质保期内故障时间顺延保修期。									

附件 3. 项目采购需求

名称	技术参数、规格、性能及配置	数量	预算单价 (万元)																								
全自动血型分析仪	<p>1、分析原理：全自动卡式微柱凝集法。</p> <p>2、检测项目：ABO 正定型，ABO 正反定型及 Rh (D) 检测，不规则抗体筛选，病人/献血者主侧与次侧交叉配血，直接/间接抗人球蛋白检测，抗体效价检测，RH 分型及 K 检测等。</p> <p>3、准确性：ABO 正定型，ABO 正反定型，Rh(D) 定型血型测定与抗人球蛋白测定符合率达到 100%。</p> <p>4、做 ABO 正反定型及 Rh(D) 检测时从标本上机到出结果首个结果时间≤8 分钟，做抗体筛查时从标本上机到出结果首个结果时间≤18 分钟（含加样、离心、孵育及结果判读的时间在内计算）。</p> <p>5、试剂架可自行转动混匀试剂，保证试剂处于均匀悬浮状态。</p> <p>6、每次可同时装载试剂卡≥140 张卡，并可连续放置添加。</p> <p>7、试剂卡打孔方式：采用专用打孔器开孔，而非加样针穿刺开孔方式。</p> <p>8、孵育系统 1：具有≥28 个孵育位，孵育系统 2：具有≥16 个常温孵育卡位，具有≥12 个 37℃ 的恒温孵育卡位。</p> <p>9、离心系统：具备双相离心功能，以两种不同的速度离心试剂卡。</p> <p>10、稀释系统：具备专用的稀释系统，可把样品自动稀释为 3-5% 和 0.8% 浓度的功能。</p> <p>11、无需一次性 TIP 吸头减少隐形成本，使用永久性钢针。</p> <p>12、试剂卡预审功能：自动识别未使用前试剂卡效期、双面状态，确保试剂卡正常完整使用。</p> <p>13、实验室讯息系统(LIS) 连接：符合国际标准自动上、下载和主机查询，具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口等双向功能。</p> <p>14、全自动血型分析仪配置清单：</p> <table border="1" data-bbox="347 1697 1086 2042"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>全自动血型分析仪</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>样本架标准尺寸-绿色 16mm</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>样本架标准尺寸-蓝色 13mm</td> <td>6 个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>样本架标准尺寸-红色 10mm</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>工具包</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>体积质控微孔板</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>扫码器</td> <td>1 个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	数量	1	全自动血型分析仪	1 台	2	样本架标准尺寸-绿色 16mm	1 个	3	样本架标准尺寸-蓝色 13mm	6 个	4	样本架标准尺寸-红色 10mm	1 个	5	工具包	1 套	6	体积质控微孔板	1 个	7	扫码器	1 个	1 套	17.0
序号	名称	数量																									
1	全自动血型分析仪	1 台																									
2	样本架标准尺寸-绿色 16mm	1 个																									
3	样本架标准尺寸-蓝色 13mm	6 个																									
4	样本架标准尺寸-红色 10mm	1 个																									
5	工具包	1 套																									
6	体积质控微孔板	1 个																									
7	扫码器	1 个																									

8	触摸显示屏	1 台
9	中文操作指南	1 本
10	配套电源线	1 根
11	恒温卡式孵育器	1 台
12	细胞洗涤离心机	1 台
13	样本离心机	2 台
14	卡式离心机	1 台
15	双目显微镜	2 台
16	冰箱冷链监控系统	6 套
17	医用冰箱 (2-8° C 含冷冻层)	3 台
18	血浆保存箱 (-20° C)	1 台
19	血液冷藏箱 (恒温 2-6° C)	2 台
20	恒温解冻箱 (恒温 37° C)	1 台
21	恒温血小板振荡保存箱 (22±2° C)	1 台
22	高频热合机	1 台
23	智能采血记录仪	1 台
24	电热恒温水浴箱	1 台
25	UPS 不间断电源	1 台
26	电脑	5 台
27	条码打印机	1 台
28	扫描枪	5 把
29	打印机 (带复印功能)	2 台
30	加样枪 (量程 5-50u1、100-1000u1、2-20u1、20-200u1)	4 把
31	加样枪放置架	1 个
32	试管架	5 个
33	血液转运箱(12L 的 2 个;6L 的 6 个)	共 8 个

商务要求

合同总价	合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统 (pacs, lis 等) 对接费用, 及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等, 直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
售后服务要求及保修期	1、按国家有关产品三包规定执行“三包”, 质保期: 整机 (含配件) 质保期不少于 2 年, 质保期内故障时间顺延质保期; 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障, 在接到采购人通知后 2 个小时内响应, 6 小时内到达故障现场处理, 一般故障处理时限不超过 24 小时修复; 3、重大故障处理时限不超过 48 小时修复, 若 72 小时内不能修复, 必须提供同档次的设备给采购方使用。 4、可提供医院要求培训能力。

交付使用时间 及地点	<p>1. 交货时间：签订合同之日起 60 个工作日内安装调试并交付使用。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
其他要求	<p>1. 采购范围内的货物含送货上门、安装调试合格、技术培训。</p> <p>3. 本项目政府采购预算金额为人民币壹拾柒万元整（¥17.00 万元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>4. 中标供应商供货时，必须提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页，并加盖投标单位公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页不一致时，以后者为准；采购人依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由中标供应商负责；</p> <p>5. 中标供应商于投标文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，中标供应商需提供操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，应通过采购人及主管部门组织的验收工作，以符合项目批准建设要求，采购人及主管部门现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>6. 本项目接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。</p>

附件 4：技术参数偏离表

供应商：

响应产品品牌/型

项目	医院设备需求 (条目式)	参加招标设备 参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
设备需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
配置清单	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
商务要求	1.			
	2.			
	3.			